

# Sistem Pemfokusan Otomatis Pada Mikroskop Digital Berbiaya Rendah Menggunakan Metode Gradient dan Statistics Based Focus Measurement Function

*by* Fajar Astuti Hermawati, Pradana Putra Kautsar, Agus Darwanto, I  
Made Kastiawan

---

**Submission date:** 04-Oct-2021 08:38AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1664327944

**File name:** 1461700015\_PradanaPutraK\_Jurnal.pdf (643.37K)

**Word count:** 2911

**Character count:** 17867

# Sistem Pemfokusan Otomatis Pada Mikroskop Digital Berbiaya Rendah Menggunakan Metode *Gradient* dan *Statistics Based Focus Measurement Function*

Fajar Astuti Hermawati<sup>1</sup>, Pradana Putra Kautsar<sup>2</sup>, Agus Darwanto<sup>3</sup> dan I Made Kastiawan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>4</sup> Teknik Mesin, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email Correspondence Author: fajarastuti@untag-sby.ac.id

## Abstract

In the scientific field, a researcher when conducting research on microscopic objects requires a microscope. Currently, digital microscopes have been widely used, in practice, digital microscopes with auto focus features have relatively high costs, while low-cost digital microscopes generally do not. has an auto focus feature so it needs experts in getting focus. therefore manual focusing results are subjective. This study proposes an automatic focusing system in a low-cost digital microscope. Automatic focusing on low-cost digital microscopes is used to improve consistency and reduce the element of subjectivity that exists when focusing is done manually. The focusing system is realized with the help of a stepper motor and Arduino as hardware in capturing image data at each focusing step, and in finding focus on the image being observed is done by comparing the Focal Value (FV) of a collection of images that have been obtained using 4 focus calculation methods based on Gradients and Statistics, namely: Gaussian Derrivative (GDR), Tenengrad based algorithms (TENG), Squared Gradient (GRAS) and Gray Level Variance (GLV). And Standard Deviation as a comparison of all these methods. The results of the search for the best focus are seen from the largest Standard Deviation value owned by the image with a normalized value of  $FV = 1$  for each method. The system was tested to observe microstructural images of polymer composite materials made from coal-based ash reinforcement and natural fibers. From the focus search experiment on 40 image data, the best focus was obtained on the 33rd data with a standard deviation of 56.2649 using the GDER, TENG, and GRAS methods.

**Keywords:** Auto-focusing, focus value, digital microscope, microstructure image.

## Abstrak

Dalam bidang keilmuan, seorang peneliti ketika melakukan penelitian terhadap objek yang berukuran mikroskopis membutuhkan alat bantu mikroskop, saat ini telah banyak digunakan mikroskop digital, dalam prakteknya, mikroskop digital dengan fitur auto fokus memiliki biaya yang relatif tinggi, sedangkan untuk mikroskop digital berbiaya rendah umumnya tidak memiliki fitur auto fokus sehingga perlu tenaga ahli dalam mendapatkan fokus. Karena itu hasil pemfokusan manual bersifat subjektif. Penelitian ini mengajukan sebuah sistem pemfokusan otomatis pada mikroskop digital berbiaya rendah. Pemfokusan otomatis pada mikroskop digital berbiaya rendah digunakan untuk meningkatkan konsistensi serta

mengurangi unsur subjektivitas yang ada ketika pemfokusan dilakukan secara manual. Sistem pemfokusan diwujudkan dengan bantuan motor stepper serta arduino sebagai perangkat keras dalam pengambilan data gambar pada setiap step pemfokusan, serta dalam mencari fokus pada citra yang sedang diamati dilakukan dengan membandingkan Focal Value (FV) dari kumpulan gambar yang telah didapat menggunakan 4 metode penghitungan fokus berbasis Gradient dan Statistic, yakni : Gaussian Derrivative (GDR), Tenengrad based algorithms (TENG), Squared Gradient (GRAS) dan Gray Level Variance (GLV). Serta Standart Deviation sebagai pembanding dari semua metode tersebut. Hasil dari pencarian fokus terbaik dilihat dari nilai Standart Deviation terbesar yang dimiliki oleh gambar dengan normalisasi nilai  $FV = 1$  dari tiap-tiap metode. Sistem diuji untuk mengamati gambar mikrostruktur dari material komposit polimer berbahan penguat abu dasar batu bara dan serat alam. Dari percobaan pencarian fokus terhadap 40 data gambar, fokus terbaik diperoleh pada data ke-33 dengan standart deviasi sebesar 56.2649 menggunakan metode GDER, TENG, dan GRAS..

**Kata kunci: Pemfokusan otomatis, nilai fokus, mikroskop digital, gambar mikrostruktur.**

## 1. PENDAHULUAN

Mikroskop merupakan perangkat yang umumnya digunakan untuk membantu manusia melihat objek berukuran mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Hal tersebut dimungkinkan karena mikroskop memiliki modul lensa perbesaran yang beragam yang dapat membuat objek berukuran mikroskopis dapat terlihat jelas oleh mata manusia. Salah satu bidang yang membutuhkan perangkat bantu berupa mikroskop adalah analisa sifat mekanis material melalui gambar mikrostruktur [1], [2].

Utamanya dalam bidang keilmuan, seorang peneliti ketika melakukan penelitian terhadap objek yang berukuran mikroskopis tentu membutuhkan alat bantu mikroskop, dimana saat ini yang telah banyak digunakan ialah mikroskop digital. Dimana dalam prakteknya, mikroskop digital dengan fitur auto fokus diperlukan biaya yang relatif tinggi untuk digunakan, sedangkan untuk mikroskop digital tanpa fitur auto fokus utamanya yang berbiaya rendah masih perlu adanya tenaga manusia untuk menentukan titik fokus yang tepat pada objek yang sedang di teliti.

Menurut [3] pemfokusan manual oleh manusia dalam hal ini menyebabkan munculnya subjektivitas dalam penentuan titik fokus objek penelitian yang berujung pada tidak konsistennya gambar fokus yang dihasilkan. Sehingga diperlukan sistem pemfokusan otomatis pada mikroskop digital berbiaya rendah guna mengurangi adanya unsur subjektivitas, serta meningkatkan akurasi, keandalan, dan konsistensi pemfokusan terhadap objek yang di teliti. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuatan

prototipe sistem pemfokusan otomatis pada mikroskop digital berbiaya rendah.

Sistem yang diusulkan berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari mikroskop digital dengan dilengkapi kontrol menggunakan arduino yang akan melakukan tuning pemfokusan pada mikroskop berdasarkan perhitungan fokus terbaik pada perangkat lunaknya. Pada penelitian ini dibandingkan beberapa teknik pengukuran fokus untuk mendapatkan hasil yang paling baik dan tajam. Dengan adanya sistem ini, diharapkan akan membantu pengamatan menggunakan mikroskop menjadi lebih mudah dan tepat.

## 2. DASAR TEORI

### A. Mikroskop Digital

Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari satu atau lebih lensa yang menghasilkan bentuk yang diperbesar dari suatu benda yang ditempatkan di area fokus lensa tersebut. Dalam perkembangan alat kesehatan, mikroskop merupakan salah satu alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda tak kasat mata skala kecil dan kasat mata.

Secara sederhana mikroskop terdiri dari lensa obyektif yang dekat dengan objek dan lensa okuler yang dekat dengan pengamat. Untuk menangkap bayangan benda yang diamati, benda tersebut diletakkan di depan lensa obyektif. Kemudian makrometer dan mikrometer diputar hingga bayangan benda terlihat. Selain itu mikroskop juga membutuhkan sumber cahaya yang digunakan untuk menerangi objek yang akan

diamati. Hal ini bertujuan untuk mengamati benda-benda kecil dari benda hidup atau mati [4].

Untuk meningkatkan nilai dan kegunaan mikroskop analog, diusulkan untuk mengubah mikroskop analog menjadi mikroskop digital. Ini dilakukan dengan memasang perangkat keras tambahan ke mikroskop manual yang ada yang juga menghubungkannya ke komputer. Sehingga mikroskop menjadi mikroskop digital. Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mikroskop digital pada dasarnya adalah perangkat lunak pengolahan gambar digital. Perangkat lunak ini mampu menangkap gambar dan menjalankan tugas pemrosesan gambar dasar [5].

### B. Blur Pada Gambar Digital

Blur pada gambar digital dianggap sebagai efek yang tidak diinginkan karena menyebabkan hilangnya detail yang diperlukan untuk interpretasi pemandangan. Deteksi otomatis piksel buram dan tajam pada gambar dan klasifikasinya ke dalam wilayah masing-masing sangat penting untuk berbagai pemrosesan gambar dan aplikasi computer vision. Manfaat segmentasi blur dapat diimplementasikan di banyak aplikasi tetapi tidak terbatas pada deteksi objek, dan segmentasi gambar [6].

Gambar yang dikatakan tajam ialah gambar yang memiliki tingkat *blur* yang rendah sehingga objek yang ada di dalam *frame* gambar dapat terlihat dengan jelas dan detail.

### C. Fungsi Pengukuran Fokus

Pengukuran fokus gambar dengan metode Gradient-based mengasumsikan bahwa gambar yang difokuskan dengan baik memiliki lebih banyak konten frekuensi tinggi. Oleh karena itu, perbedaan intensitas yang besar antara piksel tetangga mengarah ke tepi yang lebih tajam. Gradient yang lebih tinggi mewakili tepi yang lebih tajam, oleh karena itu metode pengukuran fokus ini menggunakan gradien atau turunan urutan pertama gambar untuk menemukan yang gambar dengan fokus terbaik [7].

Sedangkan pada fungsi Statistics-based, dalam prosesnya menggunakan berbagai data statistik yang dimiliki gambar seperti deviasi standar, varians, dan autokorelasi untuk menghitung derajat fokus suatu gambar [7].

### D. Gaussian Derivative (GDER)

Merupakan filter gradien yang berasal dari konvolusi gambar dengan turunan pertama Gaussian.

$$F_{GS} = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} [g(i,j) \otimes G_i(i,j,\sigma)]^2 + [g(i,j) \otimes G_j(i,j,\sigma)]^2 \quad (1)$$

Pada persamaan diatas  $G_i(i,j,\sigma)$  adalah turunan pertama dari gaussian dengan skala  $\sigma$  searah dengan  $i$ . Dimana nilai dari  $\sigma$  tergantung dari element yang dimiliki oleh gambar yang digunakan [8].

### E. Squared Gradient (GRAS)

Algoritma ini menentukan nilai fokus dengan menghitung selisih kuadrat rata-rata dari piksel yang berdekatan sepanjang sumbu horizontal dan vertikal gambar.

$$FV_{SGA} = \frac{1}{n \times m} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (g_{i+1,j} - g_{i,j})^2 + (g_{i,j+1} - g_{i,j})^2 \quad (2)$$

Dimana  $m$  dan  $n$  adalah dimensi vertikal dan horizontal gambar. Sedangkan  $g_{i,j}$  merupakan *gray level* dari *pixel* pada koordinat  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  dan  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$  dari gambar [9].

### F. Tenengrad (TEN)

Algoritma ini menggabungkan gambar dengan operator Sobel dan menjumlahkan kuadrat dari semua besaran yang lebih besar dari *threshold*.

$$F_{TEN} = \sum_{i,j} [g(i,j) \otimes S]^2 + [g(i,j) \otimes S^T]^2 \quad (3)$$

Dimana  $S$  dan  $S^T$  merupakan *kernel Sobel* dan berkaitan dengan *transpose*, yakni :

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Meskipun implementasi asli dari algoritma *Tenengrad* menggunakan ambang batas, kami memutuskan untuk menyertakan semua piksel dalam penjumlahan [8].

### G. Gray Level Variance (GLVA)

Algoritma ini menghitung variasi tingkat abu-abu antara piksel gambar. Gambar yang tajam, dalam hal ini dengan fokus yang lebih baik, dikaitkan dengan peningkatan level varian abu-abu, sementara gambar yang tidak fokus memiliki sedikit varian :

$$GLVA = \frac{1}{MN} \sum_{x,y} [I(x,y) - \mu]^2 \quad (5)$$

Dimana  $\mu$  merupakan nilai rata-rata dari distribusi tingkat keabuan [10].



#### H. Standart Deviation

Standart deviasi global menyatakan rata – rata kekontrasan dari suatu citra. *Low-contrast image* adalah citra dengan range *grey-level* yang kecil, sedangkan *High-contrast image* adalah citra dengan range *grey-level* yang besar. Kita dapat menentukan global mean dari nilai  $r$  dimana merupakan rata-rata keabuan dari citra.

$$m = \sum_{i=0}^{L-1} r_i p(r_i) \quad (6)$$

Dimana varians atau ragamnya dapat dirumuskan dengan

$$\sigma^2(r) = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^2 p(r_i) \quad (7)$$

Sehingga standard deviasi sebagai berikut :

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} \quad (8)$$

Sehingga semakin besar standar deviasi dari suatu citra maka semakin besar juga contrast dari citra tersebut, yang mana semakin besar contrast maka persebaran serta range *grey-level* dari suatu citra juga merata yang membuat citra dianggap tampil lebih jelas [11].

### 3. METODOLOGI PENELITIAN


Metode dan tahapan dari penelitian seperti yang disajikan pada Gambar 1, meliputi (1) menampilkan video dari mikroskop secara real time (2) pengambilan gambar dari mikroskop (3) penghitungan focal value (4) menentukan posisi urutan gambar dengan focal value terbaik dari setiap metode (5) membandingkan gambar dengan focal value terbaik dari setiap metode (6) menampilkan gambar hasil pemfokusan terbaik dari setiap metode (7) pembuatan perangkat keras pemfokusan (8) penyalarsan perangkat lunak terhadap perangkat keras pemfokusan (9) pembagian range focal value menjadi beberapa segment (10) pengujian dan evaluasi.

#### A. Tahap Menampilkan Video dari Mikroskop Secara Realtime

Pada tahap ini dilakukan proses menghubungkan koneksi video Mikroskop Digital dengan Matlab, dimana resolusi maksimal yang dapat digunakan ialah 1280 x 1024px pada 30fps, video preview dari Mikroskop Digital kemudian di tampilkan kedalam tampilan GUI Matlab dalam element axes dengan ukuran yang cukup besar agar dapat terlihat dengan jelas seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 1. Diagram alur penelitian

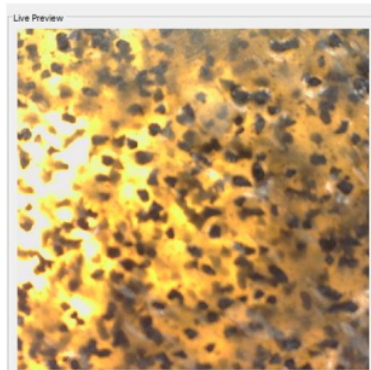

Gambar 2. Live preview mikroskop pada antar muka sistem

### B. Tahap Pengambilan Gambar dari Mikroskop

Pada tahap ini dilakukan pengambilan gambar dengan cara melakukan snapshot dari video yang di tampilkan secara real time, proses pengambilan gambar dilakukan menggunakan sebuah button yang dioperasikan secara otomatis menggunakan motor stepper untuk menentukan besaran tiap langkah pemutaran knob pemfokusan, hasil pengambilan gambar akan disimpan di folder *Capture/* dalam format gambar *.JPG* dengan tipe warna RGB berukuran spasial 1280 x 1024px. Dimana nantinya dari beberapa langkah pengambilan gambar yang telah di **26** akan dijadikan sebuah urutan gambar seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.

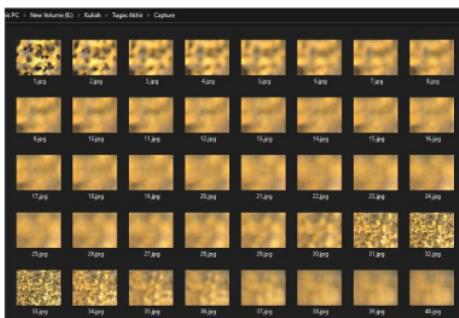

Gambar 3. Urutan hasil pengambilan gambar

### C. Tahap Penghitungan Focal Value

Pada tahap ini, urutan gambar yang telah didapatkan akan dilakukan perhitungan menggunakan metode *Gradient (Gaussian Derrivative, Tenengrad, dan Squared Gradient)* Dan *Statistics (Graylevel Variance) Based Focus Measurement Function*. Penghitungan *Focal Value* masing-masing metode menggunakan rumus yang berbeda.

(1) Gaussian **27** rivative (GDER), pada metode ini *Focal Value* didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari penjumlahan antar gambar yang diberikan filter dari turunan pertama gaussian terhadap sumbu x yang di kuadratkan dengan gambar yang diberikan filter dari turunan pertama gaussian terhadap sumbu y seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.

```
case 'GDER' % Gaussian derivative
N = floor(WSize/2);
sig = N/2.5;
[x,y] = meshgrid(-N:N, -N:N);
G = exp(-(x.^2+y.^2)/(2*sig^2))/(2*pi*sig);
Gx = -x.*G/(sig^2);
Gx = Gx/sum(abs(Gx(:)));
Gy = -y.*G/(sig^2);
Gy = Gy/sum(abs(Gy(:)));
Rx = imfilter(double(Image), Gx, 'conv', 'replicate');
Ry = imfilter(double(Image), Gy, 'conv', 'replicate');
FM = Rx.^2+Ry.^2;
FM = mean2(FM);
```

Gambar 4. Kode perhitungan Focal Value metode Gaussian Derrivative

(2) Gray Level Variance (GLVA), pada metode ini *Focal Value* didapatkan dengan cara menghitung variasi tingkat keabuan dari gambar dengan cara mencari nilai **28** rata-rata dari distribusi tingkat keabuannya seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.

```
case 'GLVA' % Graylevel variance
FM = mean2((Image-mean2(Image)).^2);
```

Gambar 5. Kode perhitungan Focal Value metode Graylevel Variance

(3) Squared **29** radient (GRAS), pada metode ini *Focal Value* didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari jumlah selisih kuadrat nilai dari suatu piksel dengan piksel tetangga yang **30** memiliki baik secara vertikal maupun horizontal seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6.

```
case 'GRAS' % Squared gradient
Ix = diff(Image, 1, 2);
Iy = diff(Image, 1, 1);
Ix(1024,:)=[];
Iy(:,1280)=[];
FM = (Ix.^2)+(Iy.^2);
FM = mean2(FM);
```

Gambar 6. Rumus perhitungan Focal Value metode Squared Gradient

(4) Tenengrad (TENG), pada metode ini *Focal Value* didapatkan dengan cara menghitung nilai total dari penjumlahan antar gambar yang diberikan filter sobel yang di kuadratkan dengan gambar yang diberikan filter transpose dari sobel yang di kuadratkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7.

```
case 'TENG' % Tenengrad
Sx = fspecial('sobel');
Gx = imfilter(double(Image), Sx, 'replicate', 'conv');
Gy = imfilter(double(Image), Sx', 'replicate', 'conv');
FM = Gx.^2 + Gy.^2;
FM = sum(sum(FM));
```

Gambar 7. Kode perhitungan Focal Value metode Tenengrad

**D. Tahap Menentukan Posisi Urutan Gambar Dengan Focal Value Terbaik Dari Setiap Metode**

Pada tahap ini, menentukan posisi urutan gambar dengan pemfokusan terbaik dilakukan dengan melihat nomor urut array dari urutan gambar dengan nilai *Focal Value* terbesar atau *maximum* dari masing-masing metode perhitungan. Kemudian posisi urutan gambar pemfokusan terbaik akan di tampilkan kedalam GUI Matlab dalam element textedit seperti yang dapat dilihat pada Gambar 8.

	GDER (Merah)	TENG (Hijau)	GRAS (Biru)	GLVA (Cyan)
Urutan Gambar Paling Fokus =	33	33	33	1

Gambar 8. Urutan gambar paling fokus dari masing-masing metode

**E. Tahap Membandingkan Gambar Perhitungan Focal Value Terbaik Dari Setiap Metode Menggunakan Standart Deviasi**


Pada tahap ini, akan dicari nilai Standart Deviasi dari gambar dengan nilai *Focal Value* terbaik dari masing-masing metode perhitungan kemudian akan di tampilkan kedalam GUI Matlab dalam element textedit seperti yang dapat dilihat pada Gambar 9. Dimana standart deviasi digunakan sebagai pembanding guna mencari keputusan akhir gambar mana yang paling fokus apabila muncul hasil lebih dari 1 nomor urut gambar, semakin besar standart deviasi suatu gambar maka semakin besar juga contrast dari gambar tersebut, yang mana semakin besar contrast maka persebaran serta range *gray-level* dari suatu gambar juga merata yang membuat gambar terlihat lebih jelas.

	GDER (Merah)	TENG (Hijau)	GRAS (Biru)	GLVA (Cyan)
Urutan Gambar Paling Fokus =	33	33	33	1
Standart Deviasi =	56.2649	56.2649	56.2649	55.8014

Gambar 9. Nilai standart deviasi dari gambar paling fokus masing-masing metode

**F. Tahap Menampilkan Gambar Hasil Pemfokusan Terbaik Dari Setiap Metode Perhitungan Fokus**

Pada tahap ini, gambar dengan pemfokusan terbaik dari hasil setiap metode perhitungan dapat di tampilkan menggunakan tombol, lihat, gambar yang di tampilkan di berasal dari posisi per motor dimana gambar tersebut diambil seperti yang dapat dilihat pada Gambar 10.

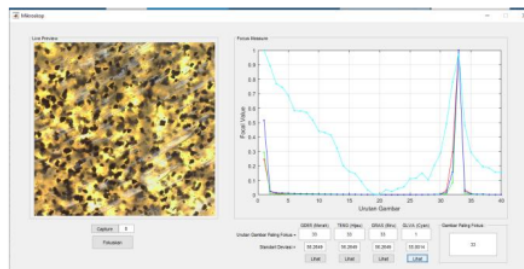

Gambar 10. Tampilan GUI Matlab ketika menampilkan gambar hasil pemfokusan terbaik.


**1**  
**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem cerdas ini dibuat dengan menggunakan software Matlab dengan tampilan GUI seperti pada Gambar 10.


Guna melakukan evaluasi terhadap sistem pemfokusan otomatis, dilakukan pemfokusan dengan posisi pengamatan objek komposit polimer yang berbeda serta melakukan pengamatan terhadap hasil fokus terbaik masing-masing metode yang digunakan.

TABEL I  
PERBANDINGAN KINERJA SISTEM PEMFOKUSAN OTOMATIS


Percobaan Ke -	Metode Dengan Gambar Paling Fokus
1	GDER, TENG, GRAS
2	GDER, TENG, GRAS
3	GDER, TENG, GRAS, GLVA

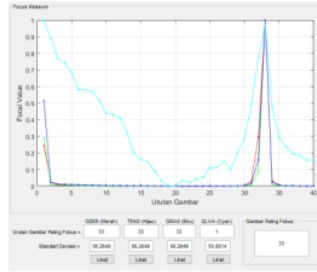

(a)

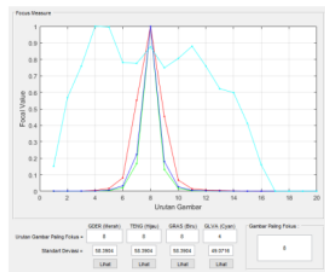

(b)

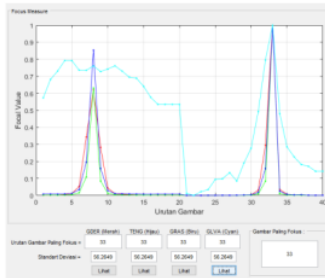

(c)

Gambar 11. Grafik Normalisasi Focal Value dan Hasil Pemfokusan dari (a) Percobaan Ke-1 (b) Percobaan Ke-2 (c) Percobaan Ke-3.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tiga kali percobaan yang telah dilakukan, metode GDER, TENG, dan GRAS selalu menjadi metode yang menunjukkan hasil pemfokusan terbaik / metode dengan gambar paling fokus, sedangkan GLVA hanya sekali muncul. Hal berikut dapat dilihat dari Gambar 11 bahwa memang dari tiga kali percobaan pemfokusan otomatis yang dilakukan metode GDER, TENG, dan GRAS selalu memiliki hasil akhir gambar dengan standart deviasi

tertinggi, sedangkan GLVA hanya pada percobaan ke-3.

21

## 5. KESIMPULAN

Dari percobaan yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perangkat mikroskop digital berbiaya rendah tanpa fitur auto fokus dapat mendeteksi fokus secara otomatis dengan adanya pengolahan citra dan penambahan perangkat keras pembantu.
2. Metode GDER, GRAS, TENG, dan GLVA dapat digunakan dalam menentukan gambar dengan fokus terbaik melalui perhitungan Focal Value.
3. Standart Deviasi dapat digunakan untuk membandingkan apabila hasil pemfokusan dari 4 metode yang digunakan menunjukkan lebih dari 1 kemungkinan gambar dengan fokus terbaik.
4. GDER, GRAS, dan TENG lebih fleksibel digunakan karena memiliki konsistensi keakuratan yang tepat dalam menentukan gambar dengan fokus terbaik.

Sistem ini diperlukan pengembangan lebih lanjut dengan menambahkan fitur pengaturan x, y, dan x axis pada mikroskop yang terintegrasi guna menambah fleksibilitas dalam proses pencarian fokus objek yang diamati.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. A. Hermawati, I. M. Kastiawan, and Muhyin, "Digital Microscopy Image Enhancement Technique for Microstructure Image Analysis of Bottom Ash Particle Polymer Composites," *Advanced Materials, Springer Proceedings in Materials*, vol. 6, no. 229, pp. 235–244, 2020.
- [2] F. A. Hermawati, I. M. Kastiawan, and Muhyin, "Automatic Filler Dispersion Quantification in Microstructure Images of Bottom Ash Reinforced Polymer Composite," *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*, vol. 48, no. 2, pp. 36–47, 2021.
- [3] M. Elessawy, M. Atia, M. Transport, and M. I. A. El-sebah, "Automation of focusing system based on image processing through intelligent algorithm," 2015, no. January 2016, pp. 26–33.



- [4] M<sup>15</sup> Kholil, R. Rulaningtyas, and W. Winarno, "Design Of Autofocus Microscope With Histogram Method For Tuberculosis Bacteria Observa<sup>28</sup>n," *Indonesian Applied Physics Letters*, vol. 1, no. 1, p. 7, 2020.
- [5] S. Hartati, A. Harjoko, and T. W. Supardi, "The digital microscope and its image processing utility," *Telkomnika*, vol. 9, no. 3, pp. 565–574, 2011.
- [6] U. Ali and M. T. Mahmood, "Analysis of blur measure operators for single image blur segmentation," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 8, no. 5, 2018.
- [7] M. I. Shah, S. Mishra, M. Sarkar, and C. Rout, "Identification of robust focus measure functions for the automated capturing of focused images from Ziehl–Neelsen stained sputum smear microscopy slide," *Cytometry Part A*, vol. 91, no. 8, pp. 800–809, 2017.
- [8] J. M. Mateos-Pérez <sup>4</sup> *et al.*, "Comparative evaluation of autofocus algorithms for a real-time system for automatic detection of Mycobacterium tuberculosis," *Cytometry Part A*, vol. 81 A, no. 3, pp. 213–221, 2012.
- [9] M. Selek, "An adaptive squared gradient algorithm for autofocusing of thermal cameras," *International Journal of Innovative Computing, Information and Control*, vol. 9, no. 2, pp. 841–849, 2013.
- [10] A. G. de Paul, R. F. Sanchez, and L. A. Issolio, "Determination of the optimum double-pass image through focus operators," *Journal of the Optical Society of America A*, vol. 35, no. 1, p. 20, 2018.
- [11] F. A. Hermawati, <sup>27</sup> *Pengolahan Citra Digital: Konsep & Teori*. ANDI Offset Yogyakarta, 2013.

# Sistem Pemfokusan Otomatis Pada Mikroskop Digital Berbiaya Rendah Menggunakan Metode Gradient dan Statistics Based Focus Measurement Function

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://prosiding.konik.id">prosiding.konik.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://sol.sbc.org.br">sol.sbc.org.br</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://alert.northeastern.edu">alert.northeastern.edu</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://aece.ro">aece.ro</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://onlinelibrary.wiley.com">onlinelibrary.wiley.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jsiskom.undip.ac.id">jsiskom.undip.ac.id</a> Internet Source	1%

[os.zhdk.cloud.switch.ch](http://os.zhdk.cloud.switch.ch)

9	Internet Source	1 %
10	<a href="#">konik.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="#">look-better.icu</a> Internet Source	1 %
12	Nur Shazwany Zamani, M. N. Mohammed, Salah Al-Zubaidi, Eddy Yusuf. "Design and Development of Portable Digital Microscope Platform using IoT Technology", 2020 16th IEEE International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA), 2020 Publication	1 %
13	Submitted to Cork Institute of Technology Student Paper	1 %
14	<a href="#">id.scribd.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="#">www.e-journal.unair.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %

18	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
19	es.scribd.com Internet Source	<1 %
20	jurnal.fp.unila.ac.id Internet Source	<1 %
21	much-zainuri.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	dindasupriatna.com Internet Source	<1 %
23	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
25	ipaespheroma.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	journal.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
27	bpm.stmik-amik-riau.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.darmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
29	mikailahaninda.blogspot.my Internet Source	<1 %



Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off